


ベムリディ[®]錠を ボトルで処方された患者様へ

—ボトルの開け方のご案内—

ベムリディのボトルは、お子様による誤飲を防ぐための工夫がなされています。無理に開けようとするとキャップの青い部分が外れる可能性がありますので、下記の説明をよくご確認ください。

ボトルをつかみ、
キャップを上から下に
押したままの状態
回してください(反時計回り)。

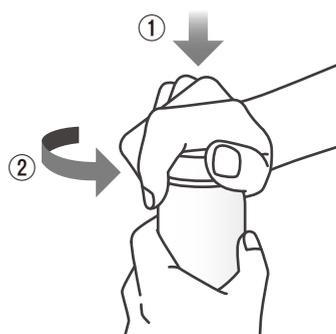

※初めて開けるときは、キャップが開けづらいことがあります。

開かないときは、2、3回押し回した後に、
キャップを持ち上げることで開きやすくなります。

※キャップを閉める際には、右方向(時計回り)に回すだけで
閉まります。キャップを押し込む必要はありません。

出荷時には、
ボトルの口にシールが貼られています。
新しいボトルを開けたときの操作は
裏面をご確認ください。




裏面につづきます ▶

新しいボトルを開けたとき

ボトル上部の シールを上から指で押して開けます。

その際、シールで指を傷つけないようにご注意ください。

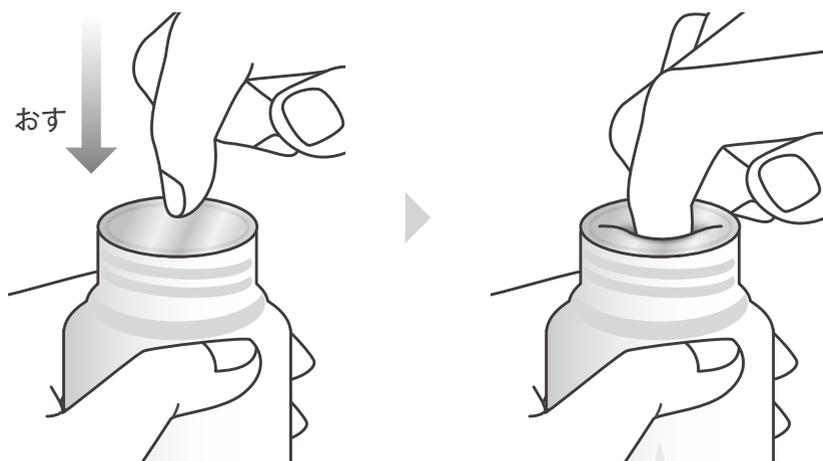

※乾燥剤が中に入っています。取り出さず、入れたままにしておいてください。
まちがえて飲まないようにご注意ください。



乾燥剤

先生の指示に従って忘れず
にお飲みください。

※お子様による誤飲を防ぐために
しっかりとキャップを閉めて保管してください。



ギリアド・サイエンシズ株式会社

メディカルサポートセンター

フリーダイヤル: 0120-506-295

9:00-17:30 (土日祝日及び会社休日を除く)

TAF18SW0112LT
2018年3月作成